


# TEKNİK RAPOR

Diski Genel M¼d¼rl¼g¼ Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetimi Daire Başkanlıđı'na bađlı Diyarbakır Arıtma Tesisinde Atıksu Kontrol Laboratuarlarında bulunan ve ařađıda marka-modelleri belirtilen Nem Tayin cihazlarının, analizlerin aksamaması iin bakım ve kalibrasyonlarının yaptırılmasına ihtiya duyulmaktadır.


Bu sebeple iř bu teknik rapor tarafımızdan tanzim ve imza edilmiřtir.05.05.2021

## Kalibrasyon ve Bakım Yapılması Gerekli Cihazlar

1. 2 Adet METTLER TOLEDO HC103 Nem Tayin Cihazı (Servis kalibrasyon bakımı yapılacaktır)
2. 1 Adet AND MX-50 Nem Tayin Cihazı (Isıtıcı lamba deđiřimi yapılacaktır)

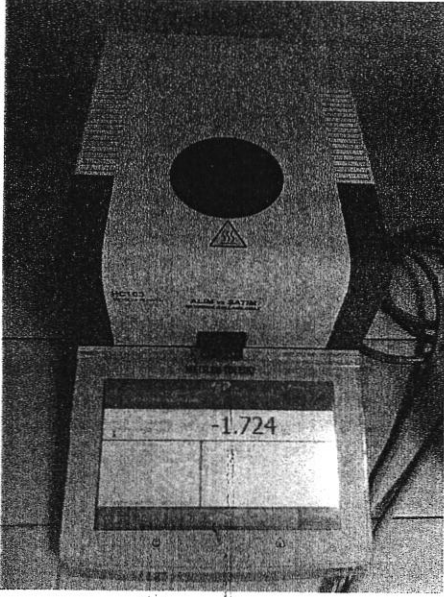

2 ADET

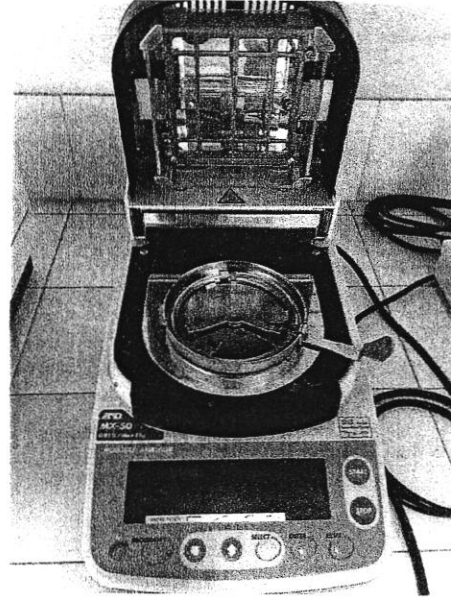

1 ADET

Eda AKDENİZ  
Analiz Sorumlusu

řeref KAPLAN  
Laboratuar Sorumlusu